ハイジーンプラン | DÜRR DENTAL HYGIENE SYSTEM

歯科医院の感染予防システム

作業方法の詳細と注意事項については、製品ラベルをよくお読みください。

www.duerr.co.jp

DÜRR DENTAL

対象物		作業手順		プランニング
器具 ミラーやスケーラーなどの一般器や外科用器具、アルカリやアルコールに敏感な回転器具の洗浄除菌		**ID213** instrument disinfection インスツルメント 器具の洗浄除菌 ハイゴボックスで浸漬除菌／超音波洗浄器使用⇨すすぎ⇨目視確認⇨乾燥⇨滅菌⇨保管 希釈液使用期限：最長2週間	50倍希釈 1ℓ希釈 ×1 2ℓ希釈 ×2 作用時間 浸漬 5分 超音波 2分	
回転器具 鋼鉄やステンレス製のバー、リーマーなどの回転器具の洗浄除菌		**ID220** rotary instrument disinfection バー／リーマー 回転器具の洗浄除菌 浸漬除菌／超音波洗浄器使用⇨すすぎ⇨目視確認⇨乾燥⇨滅菌⇨保管 注意：アルミ、真鍮製などには「ID213インスツルメント」を使用 使用期限：最長1週間	原液使用 作用時間 浸漬 1分 超音波 30秒 VIDEO 器具の洗浄除菌 ID213 ID220	
表面 材質に配慮すべき箇所：ユニットチェア、ライトのハンドル、または合成皮革やアクリルグラスなど敏感な表面の除菌		**FD366 sensitive** quick-acting surface disinfection センシティブ 表面のクイック除菌 汚染された所を原液で湿らせた状態にする⇨1分放置 ワッテまたは不織布での使用を推奨	原液使用 作用時間 1分	
		FD366 sensitive top wipes sensitive surface センシティブワイプ 表面のクイック除菌 汚染された所をワイプで拭き、湿らせた状態にする⇨1分放置	作用時間 1分 VIDEO 表面のクイック除菌 FD366 FD350	
表面 短時間で除菌すべき箇所：ハンドピース、イメージングプレートの保護カバーなどの除菌		**FD350** disinfection wipes 除菌ワイプ 表面の除菌 汚染された所を湿らせた状態にする⇨1分放置 注意：アルコールに弱い材質には「FD366センシティブ」を使用	作用時間 1分	
チェアレザー ユニットチェアの合成皮革（レザー）の清掃と保護		**FD360** cleaning and care of vinyl upholstery レザーケア 合成皮革清掃保護 レザーにスプレーし、直ちに布で拭き取る、汚れがひどい場合は専用スポンジでこすり取り残った液は乾いた布で拭き取る	原液使用	
広い表面 床、キャビネット、デンタルチェア、機器や備品等などの広範囲の洗浄除菌		**FD312** surface disinfection エコ 表面の洗浄除菌 汚染された所を希釈液で湿らせた状態にする⇨15分放置	100倍希釈 2ℓ希釈：×1 作用時間 15分	
吸引システム ユニットチェアの吸引システム、セパレーター、スピットン排水のメンテナンス、洗浄除菌、消臭	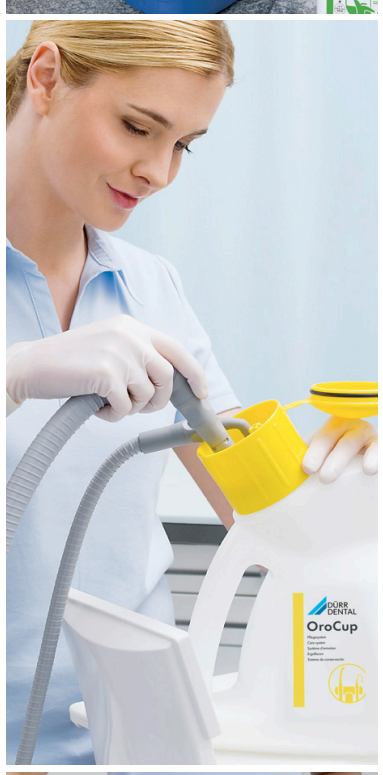	**BIOCLEAN®** disinfection of suction system バイオクリーン 吸引システムの洗浄除菌 毎日1～2回、診療終了後と昼休み前に使用 バキュームと排唾管でユニット毎に1Lを吸引⇨スピットンには1Lを流す（より高い洗浄効果を得るには先に2Lの水を吸引／流す）	毎日の洗浄除菌 アルカリ性 50倍希釈 ユニット 1台 / Bioclean 希釈液 2L ➡ 2杯 作用時間 60分	
		MD555 cleaner special cleaner for suction system フロークリーナー 吸引システム強力洗浄 週2回、昼休み前に使用 バキュームと排唾管でユニット毎に1Lを吸引⇨スピットンに1Lを流す⇨30分～2時間放置⇨2Lの水を必ず吸引	週2回の強力洗浄 酸性 20倍希釈 ユニット 1台 / MD555 希釈液 2L ➡ 5杯 作用時間 30～120分	
スピットン 水垢、血液、歯垢染色剤や型取り剤などの洗浄		**MD550** spittoon bowl cleaner スピットンクリーナー 原液をスピットンに回し入れて、スポンジやブラシで全体に塗布してから約2分放置して水で流す	原液使用 VIDEO 吸引システムの洗浄除菌 Bioclean MD550 MD555	
印象体・技工物 印象体や補綴物などの対象物すべての洗浄除菌	 	**MD520** impression disinfection インプレッション 印象体・技工物の除菌 印象体を技工士に渡す前に除菌、または対象物で作業する前に除菌 ハイゴボックス、インプボウルなどでの浸漬除菌：シンクなどで対象物を下洗い⇨5分間浸漬⇨よくすすいで乾燥 ハイゴジェット使用：対象物を機器内で水とエアーで洗う⇨「MD520インプレッション」の噴射⇨10分間放置⇨水ですすぐ⇨エアーで乾燥	原液使用 浸漬 5分 ハイゴジェット 作用時間 10分 VIDEO 印象体／技工物の除菌 Hygojet	
手指 頻繁に手を洗う方のためのマイルドなハンドクレンジング		**HD435** hand cleansing ハンドクレンジング 冷水で手を湿らし、適量（約2mL）を手に取り泡立てる⇨泡を水でよく洗い流す⇨ペーパータオルでよく乾かす	原液使用	

販売元： 株式会社ヨシダ 〈ホームページアドレス〉www.yoshida-dental.co.jp
〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9 TEL：（03）6880-2155

DDJ/Y | このカタログの内容は予告なく変更されることがあります。2025年9月